

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Martina Katonová/+420 545 135 257

V Brně dne 3. 4. 2023

Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka zařízení s regulací teploty a relativní vlhkosti vzduchu – rozděleno na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 29. 3. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 3 (k části 3 veřejné zakázky)

Může být dodávaná komora vodou chlazená (tedy vybavena vodním kondenzátorem)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu sděluje, že neakceptuje vodní chlazení, neboť laboratoř není vybavena možností použít chladicí vodu.

Dotaz č. 4 (k části 3 veřejné zakázky):

Má zadavatel možnost napojit komoru na chladicí vodu (přívod vody a odpad/odvod vody)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel k dotazu sděluje, že laboratoř není vybavena takovým zařízením.

Dotaz č. 5 (k části 3 veřejné zakázky):

Může mít dodávaná komora vnější rozměry 875 x 1786 x 1765 mm (š x h x v)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel k dotazu sděluje, že trvá na svém požadavku uvedeném v příloze č. 1c (Technická specifikace pro část c VZ), a tedy nebude akceptovat vnější rozměry 875 x 1786 x 1765 mm (š x h x v).

Dotaz č. 6 (k části 3 veřejné zakázky):

V technické specifikaci šokové komory je požadováno: „Komora musí umožňovat dosažení výrobcem deklarovaných teplotních a vlhkostních parametrů i při umístění zdroje emitujícího až 2700 W v testovacím prostoru.“

Je prosím možné tento požadavek nějak blíže popsat/vysvětlit?


Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel k dotazu sděluje, že daný požadavek je myšlen tak, že hodnota 2700W musí být chladícím systémem komory kompenzována, a to při laboratorní teplotě $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ a teplotě v komoře 25°C . Při jiných teplotách se může lišit.

Dotaz č. 7 (k části 3 veřejné zakázky)

Mohl by například zadavatel akceptovat dodání komory, která umožňuje:

- *při teplotních testech kompenzovat zdroj tepelného záření až 4500 W při teplotě $+25^{\circ}\text{C}$. Pro ostatní teploty je možné pak kompenzovat zdroj tepelného záření uvnitř testovacího prostoru dle níže uvedeného grafu:*

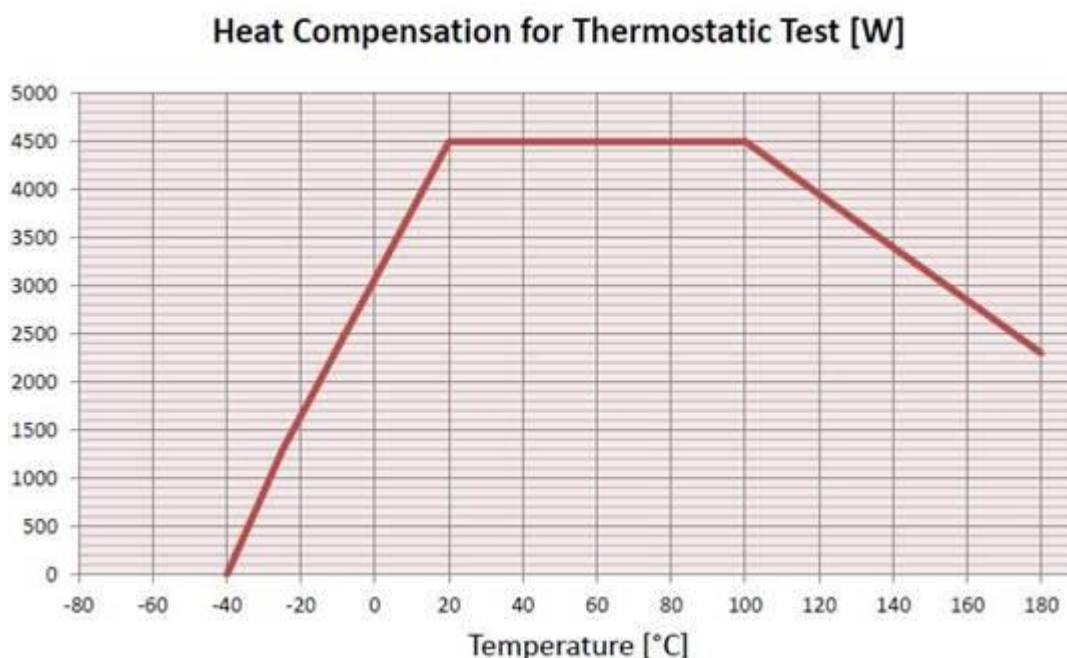

- *při klimatických testech za teploty $+25^{\circ}\text{C}$ a vlhkosti vzduchu do 90% umožní kompenzovat tepelnou zátěž v testovacím prostoru až 400 W.*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel k dotazu sděluje, že obě výše uvedené možnosti nejsou v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v příloze č. 1c (Technická specifikace pro část 3 VZ) a budou tedy akceptovány.

Dotaz č. 8 (k části 3 veřejné zakázky):

Za jakých podmínek zkoušky zadavatel očekává vyzařování tepla testovaným předmětem do testovaného prostoru 2700 W? Pouze při udržování zadaných hodnot T a vlhkosti vzduchu nebo také při snižování nebo zvyšování teploty (v oblasti teplotních ramp)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Zadavatel k dotazu sděluje, že očekává, že vzorky budou klimatizovány při standardních laboratorních podmínkách, tj. $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$. Zadavatel zároveň v návaznosti na tento dotaz aktualizoval přílohu č. 1c výzvy k podání nabídek (Technická specifikace pro část 3 VZ), ve které je tento požadavek výslovně doplněn.

II.

V návaznosti na poskytnutí tohoto sdělení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek, a to o celou původní délku, tj. do **21. 4. 2023 do 10:00 hodin.**

Příloha tohoto vysvětlení

- Aktualizovaná Příloha č. 1c - Technická specifikace pro část 3 VZ

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tuto aktualizovanou přílohu použít.

.....
Mgr. Martina Katonová
administrátorka veřejných zakázek
na základě plné moci